



2022.10.31 六甲アイランドサンプリング CTDデータ -グラフ- 1回目

平均	水温 (°C)	塩分 (‰)	蛍光量 (ppb)	濁度 (FTU)	溶存酸素(mg/L)
0.1m - 0.5m	20.36	30.96	0.95	0.75	6.60

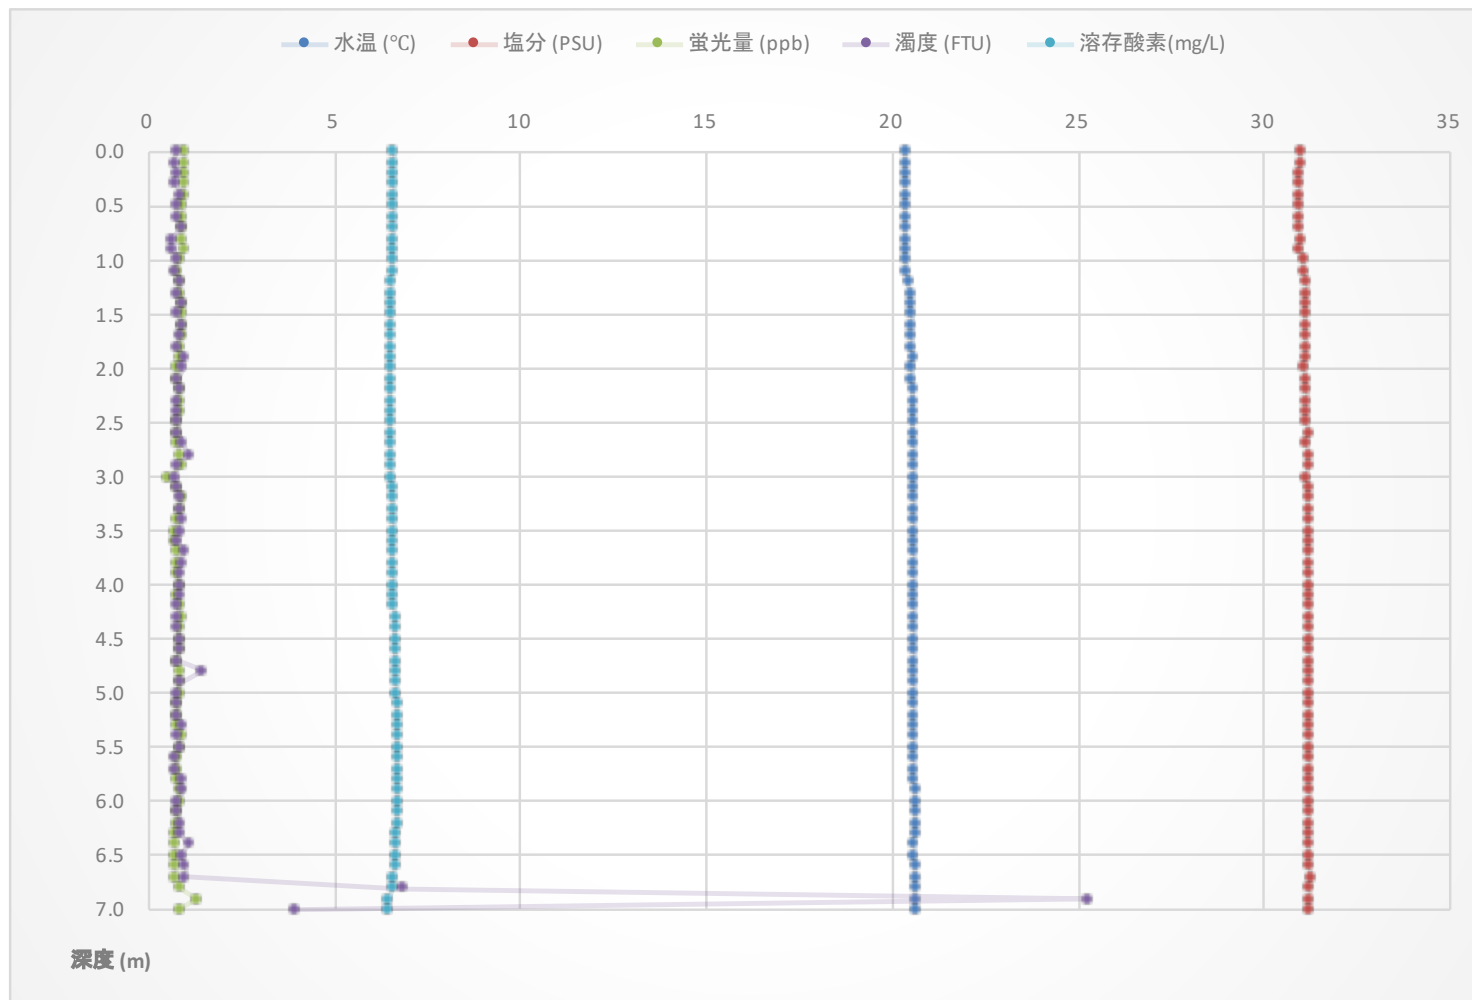

2022.10.31 六甲アイランドサンプリング CTDデータ -グラフ- 2回目

平均	水温 (°C)	塩分 (‰)	蛍光量 (ppb)	濁度 (FTU)	溶存酸素(mg/L)
0.1m - 0.5m	20.51	31.10	0.84	0.80	6.49

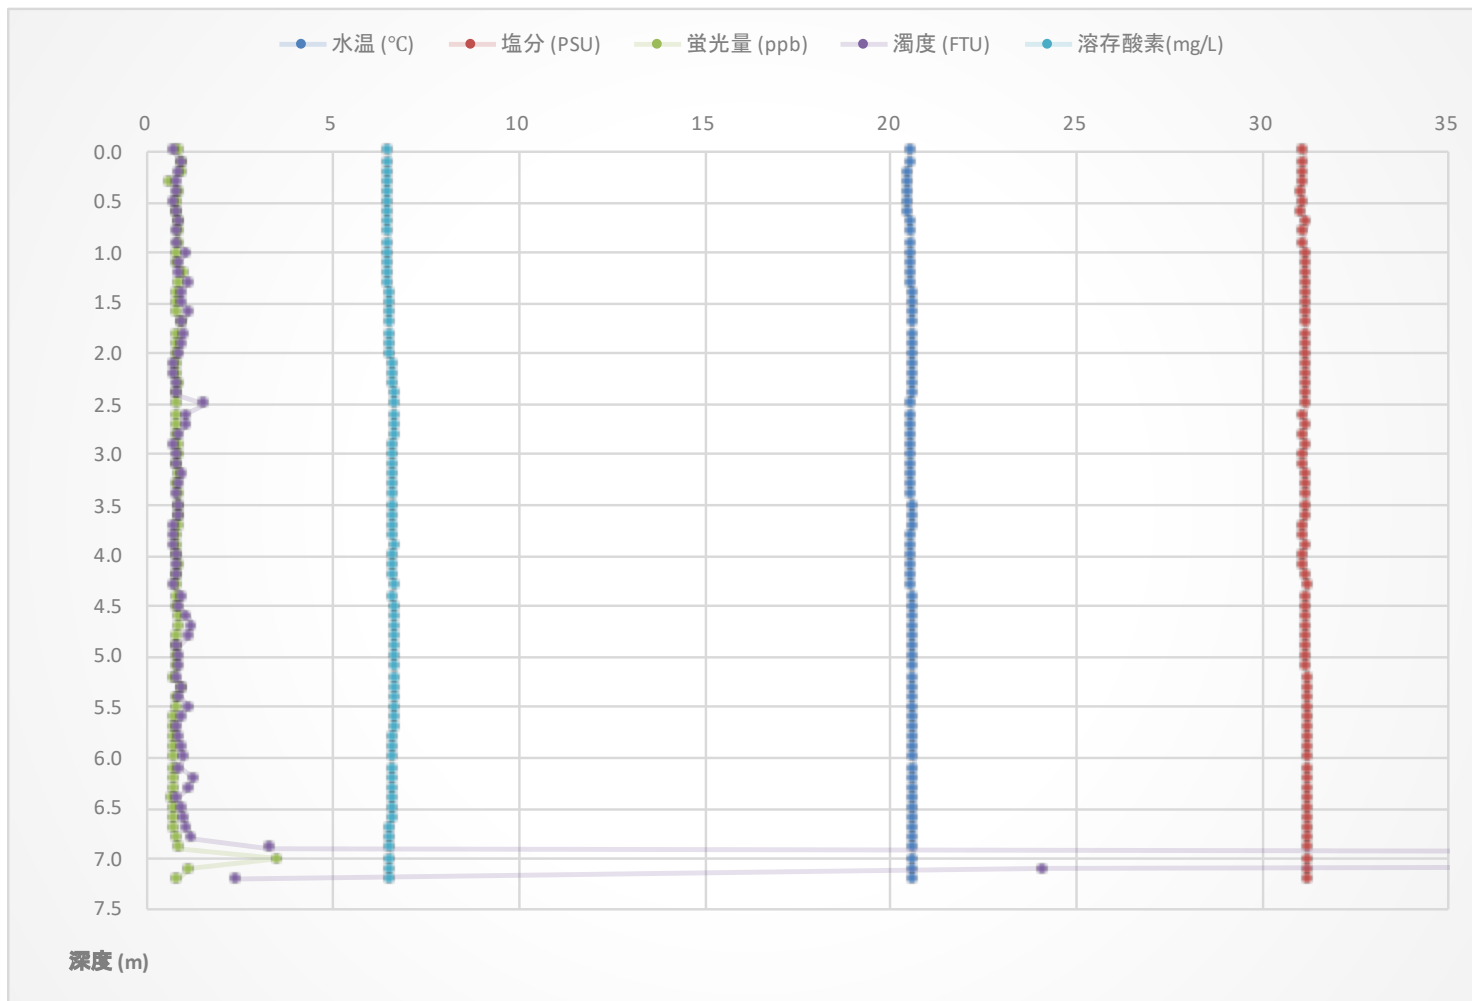

2022.10.31 六甲アイランドサンプリング CTDデータ -グラフ- 3回目

平均	水温 (°C)	塩分 (‰)	蛍光量 (ppb)	濁度 (FTU)	溶存酸素(mg/L)
0.1m - 0.5m	20.55	31.14	0.96	1.63	6.56

